

ARW-D27 説明書

クイックガイドと併せてお読みください。

基本画面	P01
機能一覧	P02
待受画面の切替	P03
通知管理 設定	P06
アラームクロック	P07
コールリマインダ	P10
健康管理	P11
言語変更	P12
画面 点灯時間の調整	P13
ユーザーデータクリア	P14
心拍数	P15
血中酸素濃度	P16
天気の確認方法	P17

基本画面



(通知画面)

設定している通知アプリのメッセージ等が表示されます。




(待受画面)



(簡易設定画面)



ナイトモード (メッセージ通知、着信をオフにします)



腕振り起動 (画面を見る腕振りで画面が点灯します)



画面、明るさ調整 (5段階)



携帯探し (携帯電話から音が鳴ります)

機能一覧の表示



待受画面が表示されている状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを押すと機能一覧が表示されます。

-  健康データ
-  エクササイズ
-  エクササイズの記録
-  心拍数
-  血中酸素濃度
-  ストレス
-  呼吸トレーニング
-  睡眠
-  天気
-  音楽
-  ストップウォッチ
-  目覚まし時計
-  タイマー
-  電話を探す
-  設定

待受画面の切替 その1



待受画面を長押し続けてください。



待受画面が小さく表示されます。左右にスワイプして画面を選択してください。

決定後、再度タップして決定になります。

待受画面の切替 その2



スマートフォンのアプリを起動させてください。

- ① デバイスをタップして画面を切り替えます。
- ② 詳細をタップします。

次のページへ



ダイヤルマーケットの画面になりましたらお好みの画面をタップしてください。

画面が切り替わりますので「インストール」をタップしてください。

お待ち頂くと待受画面が切り替わります。

この時スマートウォッチをスマートフォンの隣に置いてお待ちください。



■写真に関しまして



画面中央にあります写真はスマートフォンに保存されている写真や、新たにカメラで撮影を行い、その画像を待受けにする事が可能です。

次のページへ



①写真の選択

「アルバムから選択する」をタップするとスマートフォン内の画像から選択頂けます。

「カメラ」をタップするとカメラが起動しますので待受画面にしたい写真を撮影してください。

②色

待受けに表示する文字の色を選択頂けます。文字が見つからない場合に色を変更してください。

③場所

文字の表示位置を左上、左下、右上、右下から選択頂けます。

現在のダイヤルとして設定

画像、色、場所が決まりましたら、最後に画面したにありますが「現在のダイヤルとして設定」をタップしてお待ちください。


※この時スマートウォッチはスマートフォンの隣に置いてお待ちください。

通知管理 設定



スマートフォンのアプリを起動してください。

- ①デバイスをタップして画面を切り替えます。
- ②通知をタップします。

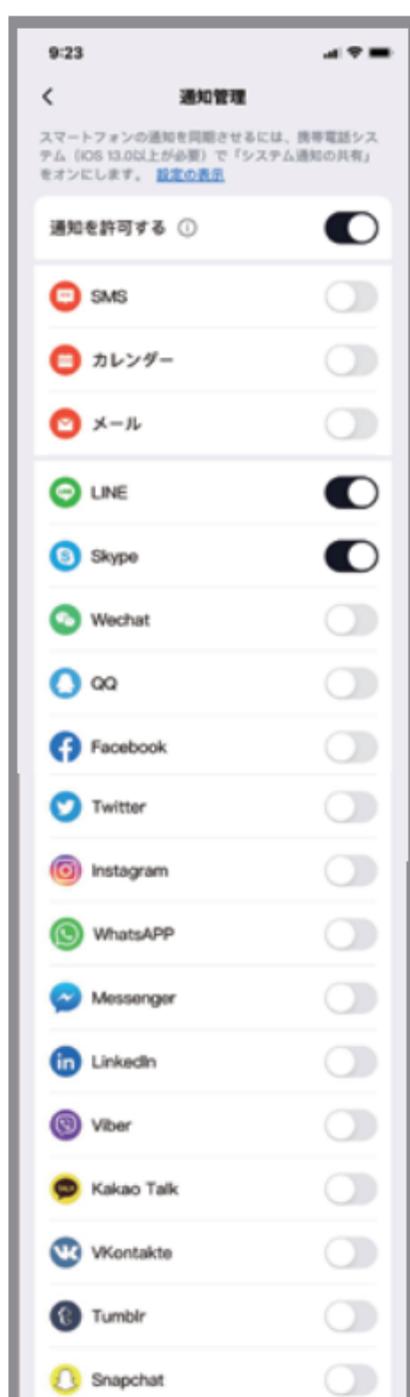

通知したいアプリをオン  にしてください。

※スマートフォン側の VeryFit の通知は必ず「通知を許可」にしておいてください。
許可を行ってない場合に通知設定を行っても通知はしません。



アラームクロック その1

※ スマートウォッチは振動と画面表示でのお知らせのみになります。音は鳴りません。



スマートフォンのアプリを起動してください。

- ① デバイスをタップして画面を切り替えます。
- ② アラームクロックをタップします。


※アラームは最大10個まで設定できます。



- ③ 画面下にある「アラームの追加」をタップしてください。

アラームの追加

次のページへ

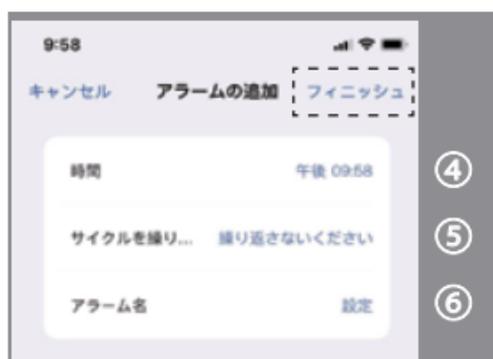

④⑤⑥を設定した後は「フィニッシュ」をタップしてください。

④時間



アラームの設定したい時間にあわせて「はい」をタップしてください。

⑤繰り返し



繰り返したい曜日を設定してください。
曜日をタップするとチェックが入ります。
最後に「はい」をタップしてください。

※1度きりのアラームの場合はこの設定は行わず「キャンセル」をタップしてください。

⑥アラーム名



アラームに名前を付けることができます。

「フィニッシュ」をタップしてください。

例



時間[午前7時]/繰り返し[月、火、水、木、金]/アラーム名[会社]で設定すると上記のような表示になります。

※10個の設定まで作ることができます。

アラームクロック その2

クロック その1 と入力方法が異なるのみであり、設定数が増えるものではありません。




待受画面を表示している状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを押すと機能一覧が表示されます。

機能一覧より「目覚まし時計」 をタップしてください。



左のような表示になりましたら  をタップしてください。



「上の段で時間」
「下の段で曜日」を設定してください。

コールリマインダ (着信設定)

※ 電話着信時の設定になります。
設定する事でスマートフォン着信時に振動するようにします。




スマートフォンのアプリを立ち上げてください。

- ①デバイスをタップして切り替えます。
- ②コールリマインダをタップします。



コールリマインダをオン にして頂くとスマートフォン着信時にスマートウォッチが振動します。

3秒遅延をオン にして頂くとスマートフォンの着信から遅れて振動するようになります。

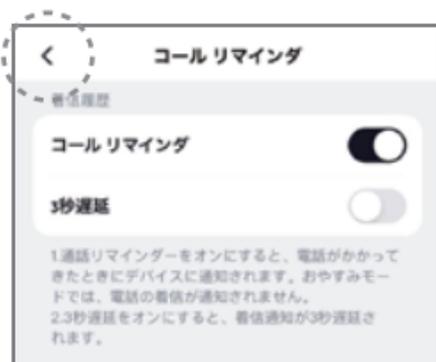

最後に  をタップして頂くと画面が切り替わり設定変更が行われます。

健康管理



スマートフォンのアプリを立ち上げてください。


- ①デバイスをタップして切り替えます。
- ②健康追跡をタップします。



心拍、ストレス、水分補給、ウォーキング、睡眠等のリマインダ設定が行えます。

※リマインダは「通知」を意味します。

例

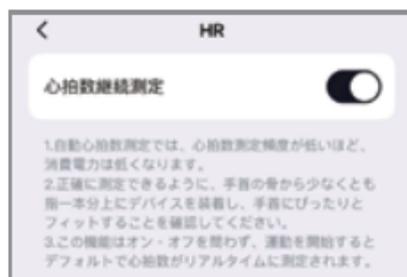

心拍数の継続測定をオンにする設定ができます。

※継続測定は通信回数が増える為、バッテリーの消耗は早くなります。

言語変更

※ スマートウォッチの言語を変更する場合は下記にて変更を行ってください。
初期の言語はペアリングして頂いたスマートフォンと同じ言語を自動的に選択いたします。



スマートフォンのアプリを立ち上げてください。

- ①デバイスをタップして切り替えます。
- ②その他の設定をタップします。



画面一番下の「デバイスの言語」をタップしてください。
変更可能な言語が表示されます。



画面点灯時間の調整



待受画面が表示されている状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを押すと機能一覧が表示されます。

機能一覧より「設定」をタップしてください。



左のように表示がでますので画面を下へスワイプしてください。



「調光」をタップしてください。



「スクリーンオン時間」をタップしてください。

5～20s から選択可能です。

ユーザーデータクリア



待受画面が表示されている状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを押すと機能一覧が表示されます。

機能一覧より「設定」をタップしてください。




左のように表示がでますので画面を下へスワイプしてください。



「ユーザーデータクリア」をタップしてください。



 チェックをタップして頂くと再度確認がでます。



再度チェックをタップして頂くとデータの消去がはじまります。

消去後はペアリング前の画面に戻ります。

心拍数

計測は椅子に座り、止まった状態で行ってください。



待受画面が表示されている状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを押すと機能一覧が表示されます。

機能一覧より「心拍数」 をタップしてください。



測定が始まります。数値が出ても終わりではありません。本体が一度振動するまでお待ちください。

※計測が出来ない場合がございます。



このような場合はスマートウォッチの装着を調整してください。この時、センサーが肌に接するようにお願いします。

血中酸素濃度

計測は椅子に座り、止まった状態で行ってください。



待受画面が表示されている状態にしてください。

この状態で画面横のボタンを押すと機能一覧が表示されます。

機能一覧より「血中酸素濃度」をタップしてください。



測定が始まります。

※計測が出来ない場合がございます。



このような場合はスマートウォッチの装着を調整してください。
この時、センサーが肌に接するようにお願いします。

天気の確認方法

その1



待受画面が表示されている状態にしてください。



画面を右から左に何度かスワイプしてください。

左のように天気が表示されます。

その2



待受画面が表示されている状態にしてください。

この状態で物理ボタンを押すと機能一覧が表示されます。

機能一覧より「天気」  をタップしてください。



左のように天気が表示されます。